家贝®
专注水质检测

使用说明 A21-1

型号　A21-1

便捷式PH笔



主要技术指标：

范　围 ：0.00~14.00PH
分辨率：0.01PH
精　度 ：±0.1PH
电　池 ：4x1.5V (AG-13)
温度补偿：0℃~50℃
工作温度：0℃~50℃
尺寸：151mmx33mmx20mm
重量：53g

电池安装：
若背光亮度明显下降或显示值模糊,则应更换电池。更换电池时，拉出电池仓更换即可，注意电池的正负。

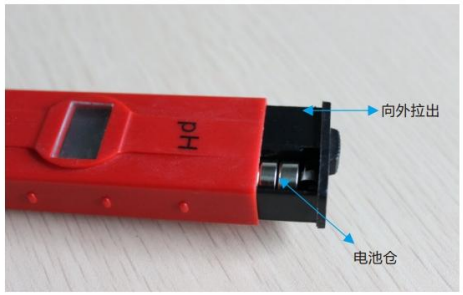

售后服务:
本仪器从出厂之日起保修6个月，担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器寄给我们的代理商或我公司，我们将予维修。

感谢您使用我们的产品。 为了您更好的使用
请遵循本产品的手册。

操作步骤：
1. 取下保护套，先用蒸馏水清洗电极 ,并用滤纸吸干附在电极上的水分；
2. 接通位于电池仓上的开关；
3. 将PH笔电极插入被测溶液中，直到液体浸到略底于"水位线"处；
4. 轻轻搅动后静置，待数值稳定，读取显示值；
5. 使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。



1. 取下保护套，用清水清洗电极，接通位于电池仓 上的开关



2. 将ph笔插入被测溶液中，刚接触水时，数值会 不断跳动，待数值稳定后再读取显示值

注意事项：
1. 此ph笔不能测酸性低于2或碱性高于12的强酸强碱性液体，否则会导致玻璃电极爆裂；
2. 不能测试水温高于40℃的溶液，否则会导致玻璃电极爆裂；
3. 玻璃电极属于易碎品，不要用硬物或手指触碰玻璃电极，避免破裂；
4. 液体不要接触到超过笔盖高度，以免ph计进水损坏电路板。
（以上四种操作失误均不在售后保修范围内）
5. 测试ph酸碱度值一般要几分钟，等待数值极缓慢跳动或上下跳动时读取显示值为测量值；
6. ph笔在空气中的显示数值是乱跳的，是没有规律的变化的，属正常现象 ；
7.ph笔电池在取出或者更换后重新开机时，由于芯片重启，ph笔需要重新校正后才能使用；
8.此笔出厂前已校正，顾客收到货后无需校正可立即使用。

Ph校准步骤：



1. 配置校准液，一包校准粉要用250ml蒸馏水/纯净水 配成标准缓冲液。(配置好的标准液保存好可留着下次使 用)



2. 将ph笔放进标准缓冲液中，等待几分钟，数值会稳 定下来或在两个数之间徘徊，再用小螺丝刀左右旋转调 节，直到屏幕数值与标准缓冲液的ph值是一样



3. 重复以上两个操作步骤，可以校准ph4.01/ph 9.18(每次校准完后，要用清水清洗电极才可进行下一 个校准)

公司信息:
公司名称 : 广州家贝水处理有限公司
地　　址 : 广州市番禺区大龙街道新水坑村大巷街13号
邮　　编 : 511430
电　　话 : 020-85542368
手　　机 : 13826263031
邮　　箱 : 100@jubway.com