家贝®
专注水质检测


使用说明 A52

型号 A52



型号/名称	A52家贝测水笔			
功能	TDS	pH	EC	TEMP(温度)
测量范围	1—9999ppm	0.00-14.00	1-19999μs/cm	0-60℃ 32-140°F
分辨率	1 ppm	0.01 pH	1 μs/cm	0.1°C/0.1°F
测量精度	±2%	(1点校准) ±0.1pH (2/3点校准) ±0.05 pH	±2%	±0.5°C
校准	1413μs/cm 标准溶液	pH 6.86/4.00/9.18	1413μs/cm 标准溶液	-
电池	3*LR44纽扣电池1.5v，待机5分钟后自动关机			
温度补偿	自动温度补偿			
使用环境	0-60°C(32.0-140.0°F)；相对湿度RH 100%			
尺寸/重量	188x37x37mm 90g			

温度单位（℃/℉）设置

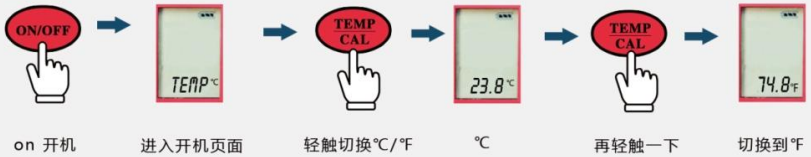

on 开机　进入开机页面　轻触切换℃/℉　℃　再轻触一下　切换到℉

注意：因产品具备记忆功能，所以产品开机界面为上次关机模式

模式（pH/EC/TDS）设置




on 开机　进入开机页面　轻触切换pH/EC/TDS　pH　再轻触一下　切换到EC　切换到TDS　再轻触一下

注意：因产品具备记忆功能，所以产品开机界面为上次关机模式

广州家贝水处理有限公司　　联系电话：13826263031

校准步骤


pH校准

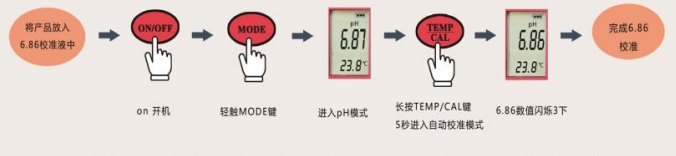

on 开机　轻触MODE键　进入pH模式　长按TEMP/CAL键5秒进入自动校准模式　6.86数值闪烁3下



on 开机　轻触MODE键　长按TEMP/CAL键5秒进入自动校准模式　进入6.86数值校准　轻触TEMP/CAL键1下　4.00数值闪烁3下

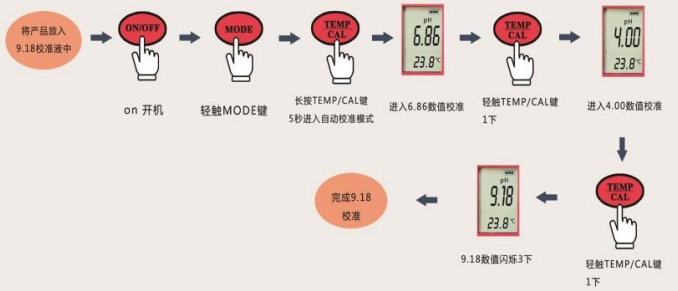

on 开机　轻触MODE键　长按TEMP/CAL键5秒进入自动校准模式　进入6.86数值校准　轻触TEMP/CAL键1下　进入4.00数值校准　9.18数值闪烁3下　轻触TEMP/CAL键1下

EC校准

注：此产品电导率出厂时已校准，无需再次校准，如需校准，请使用1413μs/cm标准溶液，步骤如下：



on 开机　轻触MODE键　进入EC模式　长按TEMP/CAL键5秒　1413数值闪烁3下

TDS校准

注：此产品TDS出厂时已校准，无需再次校准，如需校准，请使用1413μs/cm标准溶液，步骤如下：



on 开机　轻触MODE键　进入TDS模式　长按TEMP/CAL键5秒　1413数值闪烁3下

注意：.产品在校准过程中不能离开校准溶液，如出现ERR 错误，需重新校准

校准完成后，用蒸馏水或者去离子水清洗电极，用滤纸吸干水分，放到待测溶液中，可得准确数值

注意：

1、此产品TDS和EC参数出厂时已校准，无需再次校准；
2、PH标准溶液配制需要用到纯净水，配制方法：将整一包粉状标准溶液溶于250ml纯净水中，并搅拌至完全溶解，既得PH该浓度的标准溶液；
3、校准操作时，每校准完一个浓度，均需要用下一个浓度清洗一下探头或者用纯净水清洗探头再进行检测。

产品特点：

两种温度 随意切换




℃摄氏度　℉华氏度

三种功能 随意切换



显示TDS值　显示pH值　显示EC值



防尘防泼水设计



可更换式灵敏电极头



背光 屏幕双显示